


# Guía rápida - Quantum Blue® Reader de 3ª generación - Fast Track Mode




Encienda el Quantum Blue® Reader y siga las instrucciones de la pantalla.

Si se le solicita, introduzca el ID de usuario y la contraseña.

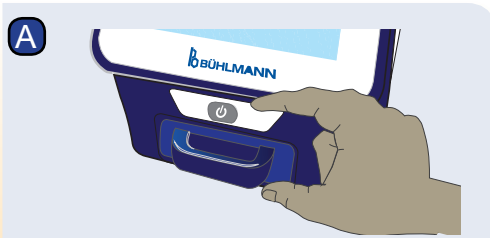

Para iniciar una nueva medición, pulse «INICIO NUEVA PRUEBA».

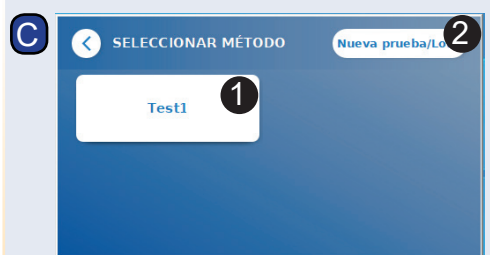

Seleccione una de las pruebas disponibles (C, 1) y proceda con el paso D, o pulse «Nueva prueba/Lote» (C, 2) para introducir un nuevo método y continúe con el paso E.




Si la identificación de lote requerida está disponible en la lista, selecciónela en el menú (D, 1) y continúe con el paso H.

Si la identificación de lote requerida no está disponible, pulse «Nueva prueba/Lote» (D, 2) y continúe con el paso E.




Abra la bandeja y coloque la tarjeta de código de barras en el soporte como se muestra.

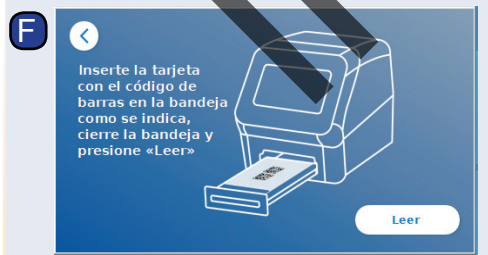

Cierre la bandeja e inicie el proceso de lectura pulsando «Leer». Esto carga el método de prueba apropiado en el lector.




Retire la tarjeta de código de barras y pulse «Continuar».

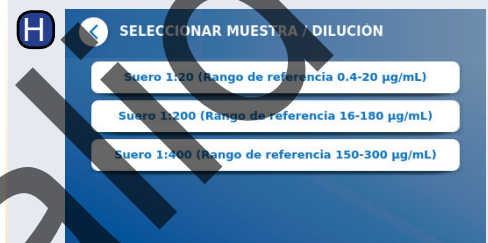

Para algunos métodos de prueba es necesario seleccionar el tipo de muestra y/o su dilución.

Si se le solicita, elija el tipo de muestra y/o la dilución de la muestra en el submenú opcional.

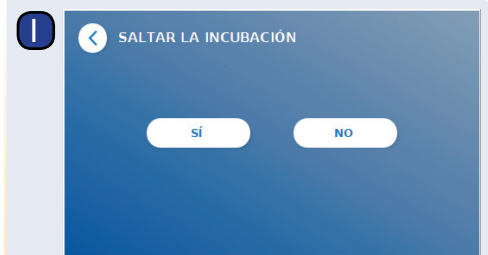

En la pantalla «SALTAR LA INCUBACION», pulse «SÍ» si el tiempo de incubación se controla mediante un cronómetro externo. Pulse «NO» si el tiempo de incubación debe ser medido por el lector.



En la pantalla aparece un cuadro resumen de todos los parámetros específicos de la prueba.

Si el resumen y los ajustes específicos de la prueba son correctos, pulse «Continuar». En caso contrario, tiene la opción de volver (◀) al paso C para cambiar los ajustes de la prueba.




Introduzca la identificación del paciente/muestra usando el teclado o mediante un escáner de código de barras externo\*.

Deben introducirse al menos 3 caracteres. Pulse «Continuar» para ir a la pantalla de medición.

## CRONÓMETRO EXTERNO «SÍ» SELECCIONADO EN «SALTAR LA INCUBACIÓN»

L1



Retire el casete de prueba de su empaque. Aplique la muestra en el puerto de carga de muestra del casete de prueba. (L1)...


Nota: Para los volúmenes de aplicación, consulte las instrucciones de uso del ensayo correspondientes.

L2



... y programe de forma manual un cronómetro (L2). El tiempo de incubación específico de la prueba se establece en las instrucciones de uso del ensayo correspondientes.

L3

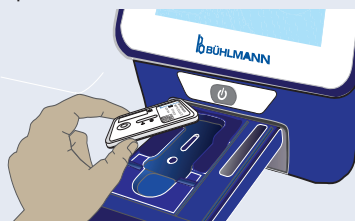

Abra la bandeja y coloque el casete de prueba en el soporte como se muestra (L3).


M



Cierre la bandeja y pulse «Iniciar medición» una vez que el tiempo de incubación haya terminado. El lector medirá el casete de prueba (N2).

## CRONÓMETRO INTERNO «NO» SELECCIONADO EN «SALTAR LA INCUBACIÓN»

L1



Retire el casete de prueba de su empaque. Aplique la muestra en el puerto de carga de muestra del casete de prueba. (L1)...

Nota: Para los volúmenes de aplicación, consulte las instrucciones de uso del ensayo correspondientes.

L2



Abra la bandeja y coloque el casete de prueba en el soporte como se muestra (L2)...

M




... cierre la bandeja y, a continuación, pulse «Iniciar medición».

N1



El lector realizará la prueba, comenzando con la incubación específica de la prueba (N1), seguida de la medición del casete de prueba (N2).

O

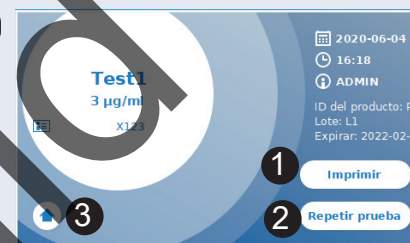

El resultado se muestra en la pantalla de resumen de resultados. Se puede imprimir el resultado (O, 1), repetir la prueba con los mismos ajustes (O, 2) o volver a la pantalla de inicio (O, 3).

Nota: Los resultados se guardan automáticamente. La impresión requiere la conexión por USB a una impresora dedicada\*.

Pulse el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar el Quantum Blue® Reader.

\*para más detalles, consulte el capítulo «Instalación de del equipo/Accesorios» del manual del Quantum Blue® Reader



BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Suiza  
Teléfono +41 61 487 12 12  
Fax +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch